

TherapyAir®

By Zepter Group

P U R I F I E D A N D E N R I C H E D A I R



TherapyAir®

By Zepter Group

Świat szybko się zmienia i dostarcza nam nowych problemów. Firma, która chce odnosić sukcesy na rynku, nieustannie musi za tymi zmianami nadążyć i proponować nowe rozwiązania. Te zaś powinny się opierać na trwałych wartościach. Firma Zepter zawsze doceniała jakość, innowacyjność, oryginalne patenty oraz solidność wykonania. Tylko dzięki wierności tym zasadom udało nam się uzyskać tak wspaniałe wyniki.

Zepter systematycznie bada potrzeby swoich klientów. Wieloletnie doświadczenia przy tworzeniu produktów służących podnoszeniu jakości naszego życia w połączeniu z pracą zespołu najlepszych inżynierów i konstruktorów, pozwala nam na zaprezentowanie produktu nowej generacji, bez którego nie będzie można obejść się w domu, w pracy, w sklepie, aptece, gabinecie lekarskim, siłowni, szkole...

Od momentu ogłoszenia przez WHO (Międzynarodową Organizację Zdrowia) „epidemii złej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń” najlepsi eksperci ZEPTERA poszukiwali najbardziej skutecznego sposobu jego oczyszczania.

Wynik ich pracy to właśnie urządzenie Therapy Air® - system oczyszczania i uzdatniania powietrza wewnątrz pomieszczeń. To nowy członek rodziny Zeptera, zajmujący ważne miejsce w naszej kompleksowej ofercie produktów tworzonych z myślą o naszym zdrowiu i urodzie. Można powiedzieć, że Therapy Air to lekarz powietrza w naszych domach i miejscach pracy, który tym samym będzie dbał o nasze zdrowie. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym urządzenie skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i emituje do powietrza substancje zapachowe, które poprawiają zdrowie i samopoczucie.

Dzięki Therapy Air® będą Państwo mogli oddychać czystym, zdrowym powietrzem.



Zanieczyszczenia i kurz są wszędzie wokół nas.



Corocznie wnoszą się w atmosferę biliony ton pyłu.

Z czego składa się powietrze atmosferyczne?

Zanieczyszczenia i kurz są wszędzie wokół nas. Często możemy zaobserwować wpadające przez okno promienie słoneczne. W ich świetle widać, jak wiele kurzu wiruje w stojącym przecież powietrzu. A to jest zaledwie ułamek całości widoczny gołym okiem, bowiem ponad 99% to mikroskopijny, niewidoczny kurz. Razem z wdychanym powietrzem do naszego organizmu przedostają się miliony cząsteczek pyłu powodującego często ciężkie choroby, a nawet śmierć. A czy my zastanawiamy się, co zawiera powietrze, którym oddychamy?

Spójrzmy na pustą szklanę. Wygląda na pustą, ale w jej wnętrzu kłębi się co najmniej 25 000 mikroskopijnych cząsteczek pyłu. A pyłki te zawierają fragmenty wszystkiego, co mieści się na Ziemi i ciągle się wymieniają.

W małych rzeczach tkwi ogromna siła. To one przedstawiają początek, są symbolem istnienia i życia. Wszyscy znamy fragment z Biblii, który zaczyna się słowami: "Z prochu powstałeś...", a współczesna fizyka dostarcza dowodów, że w pierwszej chwili po powstaniu całej wszechświat był najdrobniejszą cząsteczką materialną. Niestety, najdrobniejsze cząsteczki mogą też oznaczać koniec.

W jaki sposób drobinki znajdujące się w powietrzu wpływają na nasze zdrowie? Jakie powietrze jest nam naprawdę potrzebne? Warto się zastanowić.


Powietrze atmosferyczne to mieszanina gazów składająca się z azotu, tlenu, dwutlenku węgla, gazów szlachetnych, pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia naturalnego oraz tych wytworzonych przez człowieka. Corocznie wnoszą się w atmosferę biliony ton pyłu naturalnego - pustynnego piasku, cząsteczek soli znad oceanów, popiołu wulkanicznego, chemikaliów organicznych wydzielanych przez rośliny oraz pyłków kwiatowych, mikroorganizmów, zarodników grzybów itp., jak również pyłu antropogenicznego związanego z działalnością człowieka - związków siarki, tlenku azotu, spalin, ołowiu, miedzi, węglowodorów itp. Właśnie te sztuczne zanieczyszczenia, stanowiące aż 20% wszystkich zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, są największym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi.

Co dalej się dzieje z tą niewyobraźną ilością błakającego się po atmosferze pyłu?

Rzeki pyłów opływają świat z prądami powietrza, roznosząc po świecie ich ogromne ilości. Fotografie satelitarne rejestrujące te rzeki, wyjaśniają ciekawe zagadki naukowe. Dzięki nim na przykład stwierdzono, że tony pyłu Sahary przebywają tysiące mil i zbierając po drodze różne zanieczyszczenia, docierają do każdego zakątka Europy i Ameryki. Na północy Szwecji i Finlandii spadają w postaci szaro-pomarańczowego śniegu; w Wielkiej Brytanii według dr. Dale'a Griffina z U.S. Geological Survey obłok skażonego pyłu z Sahary wywołał wśród zwierząt hodowlanych ogromną epidemię pryszczycy w 2001 r.

Można też udowodnić, że jeden z największych pokładów boksytu na świecie, znajdujący się na Jamajce, dosłownie przeleciał pojedynczymi pyłkami z Sahary przez Ocean Atlantycki na Karaiby. Chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, po wybuchu wulkanu Krakatau w 1883 r. do atmosfery dostało się 150 milionów ton pyłów, które krążyły wokół Ziemi kilka lat, a radioaktywny obłok z Czarnobyla dotarł aż do Japonii.

Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umierają miliony ludzi. Tylko w Chinach jest to przerażająca liczba miliona osób, w Rosji ponad 200 tysięcy. W USA i w Niemczech ciągle rośnie liczba chorych na alergię, astmę i nowotwory, coraz więcej osób umiera z powodu zaburzeń działania układu sercowo-naczyniowego itp. Czy

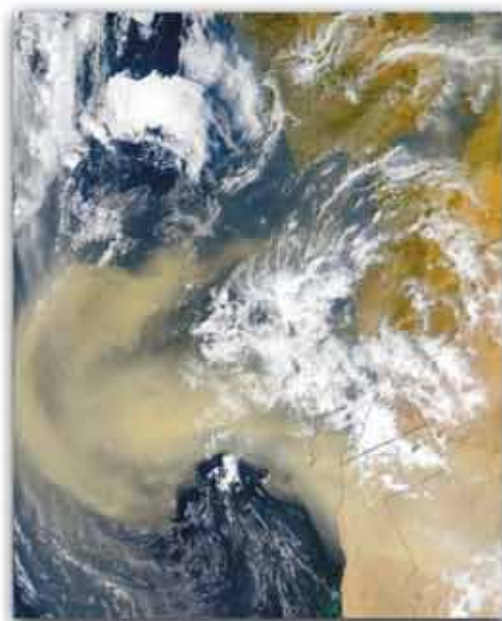

Rzeki pyłów opływają świat z prądami powietrza.



sytuacja w naszym kraju jest lepsza?

Poszukując przyczyn gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na ww. choroby w ostatnich dziesięciu latach, jak również przyczyn pojawienia się nowych, nieznanych chorób, naukowcy zwrócili uwagę również na jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

Niestety, nie mamy pewności, że gdziekolwiek na Ziemi jest jeszcze czyste powietrze.



Powietrze wewnątrz pomieszczeń zawiera do 100 razy więcej toksycznych substancji niż powietrze na zewnątrz.



Z każdym oddechem wdychamy od 40 000 do 75 000 cząsteczek kurzu.

Substancje toksyczne - zagrożeniem dla zdrowia człowieka

Okazało się, że powietrze wewnątrz pomieszczeń zawiera od 4 do 10, a w niektórych przypadkach i do 100 razy więcej toksycznych substancji niż powietrze na zewnątrz. Nowe materiały budowlane oraz te, z których są produkowane elementy wyposażenia domu, powodują ulatnianie się wielu substancji toksycznych zanieczyszczających powietrze. Najwięcej toksycznych substancji emitują wykładziny i dywany, tworzywa sztuczne potrzebne do ich produkcji, meble, kleje, farby, lakiery, nowoczesne materiały budowlane, materiały syntetyczne, plastiki, środki owadobójcze, świece itp. Nasz organizm nie jest przygotowany do walki z ulatniającymi się: formaldehydem, azbestem, ołowiem czy z węglowodorami aromatycznymi, paradychlorobenzenem itp. i jednocześnie z pyłkami roślin, cząsteczkami wełny, bawełny, lnu, dymem tytoniowym, zarodnikami grzybów, mikroorganizmami, roztozcami, bioaerozolami itp., które i tak sprawiały nam wiele kłopotów zdrowotnych. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych już jest inne niż pięćdziesiąt, trzydzieści czy nawet dwadzieścia lat temu. To wróg podstępny, nieustannie zmieniający oblicze, na gorsze.

Nasze mieszkania, domy i biura, w których spędzamy 90% czasu, Agencja Ochrony Środowiska USA (EPA) zaliczyła do pięciu największych źródeł zanieczyszczenia środowiska!

Dorosły człowiek codziennie wykonuje 22 000 oddechów, wdychając od 15 000 do 20 000 litrów powietrza. Z każdym oddechem wdychamy od 40 000 do 75 000 cząsteczek kurzu. Jeden gram kurzu zawiera 700 milionów różnych cząsteczek składowych stanowiących razem ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia. Nasz organizm w procesie ewolucji przystosował się do walki z pyłem, ale dzisiaj pył ma zupełnie inną strukturę chemiczną, jest o wiele bardziej niebezpieczny.

Większe zanieczyszczenia powietrza zatrzymywane są podczas oddychania już na pierwszej linii obrony, w lepkich nozdrzach, a jeśli się przedostaną dalej, muszą pokonać krtań i oskrzela, skąd najczęściej są usuwane z organizmu przez następne mechanizmy obronne w drodze do płuc. Najmniejsze cząsteczki przedostają się głęboko, do 500 milionów pęcherzyków płucnych.

Nasze płuca coraz rzadziej z nimi wygrywają. Pył jest przyczyną wielu chorób, a bardzo często i śmierci. Według najnowszych badań, powiększenie stężenia pyłu w powietrzu o 10 mikrogramów na jeden metr sześcienny powoduje wzrost liczby zgonów od 0,5 do 1 %, 10% więcej ataków astmy i do 25% więcej przypadków zapalenia oskrzeli.



Badania przeprowadzone w USA wykazują, że liczba chorych na astmę powiększa się co dziesięć lat o 50%, z czego wynika, że w 2010 roku co dziesiąta osoba będzie chora. Wg badań Instytutu INFAS w 1989 roku 21% Niemców chorowało na alergię. W roku 2000 ta liczba wynosiła już ponad 30%. Wzrost liczby zachorowań na raka jest również bezpośrednio związany ze zmianą struktury powietrza. Przez złą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń coraz więcej osób choruje na wszelkie choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i inne. Zidentyfikowano nawet nową chorobę, ściśle związaną z przebywaniem w pomieszczeniach z zatrutym powietrzem i nazwano ją „zespołem chorych budynków”. Ma objawy podobne do grypy, które trwają latami i mogą doprowadzić do zniszczenia systemu odpornościowego, a nawet do śmierci. Eksperti Agencji Ochrony Środowiska USA (EPA) twierdzą, że wywołuje ją aż 60% budynków w Stanach Zjednoczonych, a między innymi, w co trudno uwierzyć, sam gmach EPA.

A wszystko to odbywa się obok ogromnego postępu medycyny. Nie pomogą nam operacje, antybiotyki i inne leki w leczeniu całego szeregu najgroźniejszych chorób, jeżeli nie usuniemy przyczyn tych chorób i będziemy dalej w kontakcie z czynnikami, które je powodują. A one znajdują się w powietrzu.


Eksperti Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzegają, że jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń bardziej wpływa na nasze zdrowie niż powietrze na zewnątrz.

Zidentyfikowano nową chorobę ściśle związaną z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych.

Nazwano ją „zespołem chorych budynków”.

Czy z tej groźnej sytuacji jest jakieś wyjście?

Zepter znów znalazł rozwiązanie. Jest nim wspaniały, niezawodny, najnowocześniejszy system oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń - Therapy Air® - dzięki któremu będziemy mogli oddychać czystym, nieskażonym powietrzem, jakie natura pierwotnie dla nas przewidziała.

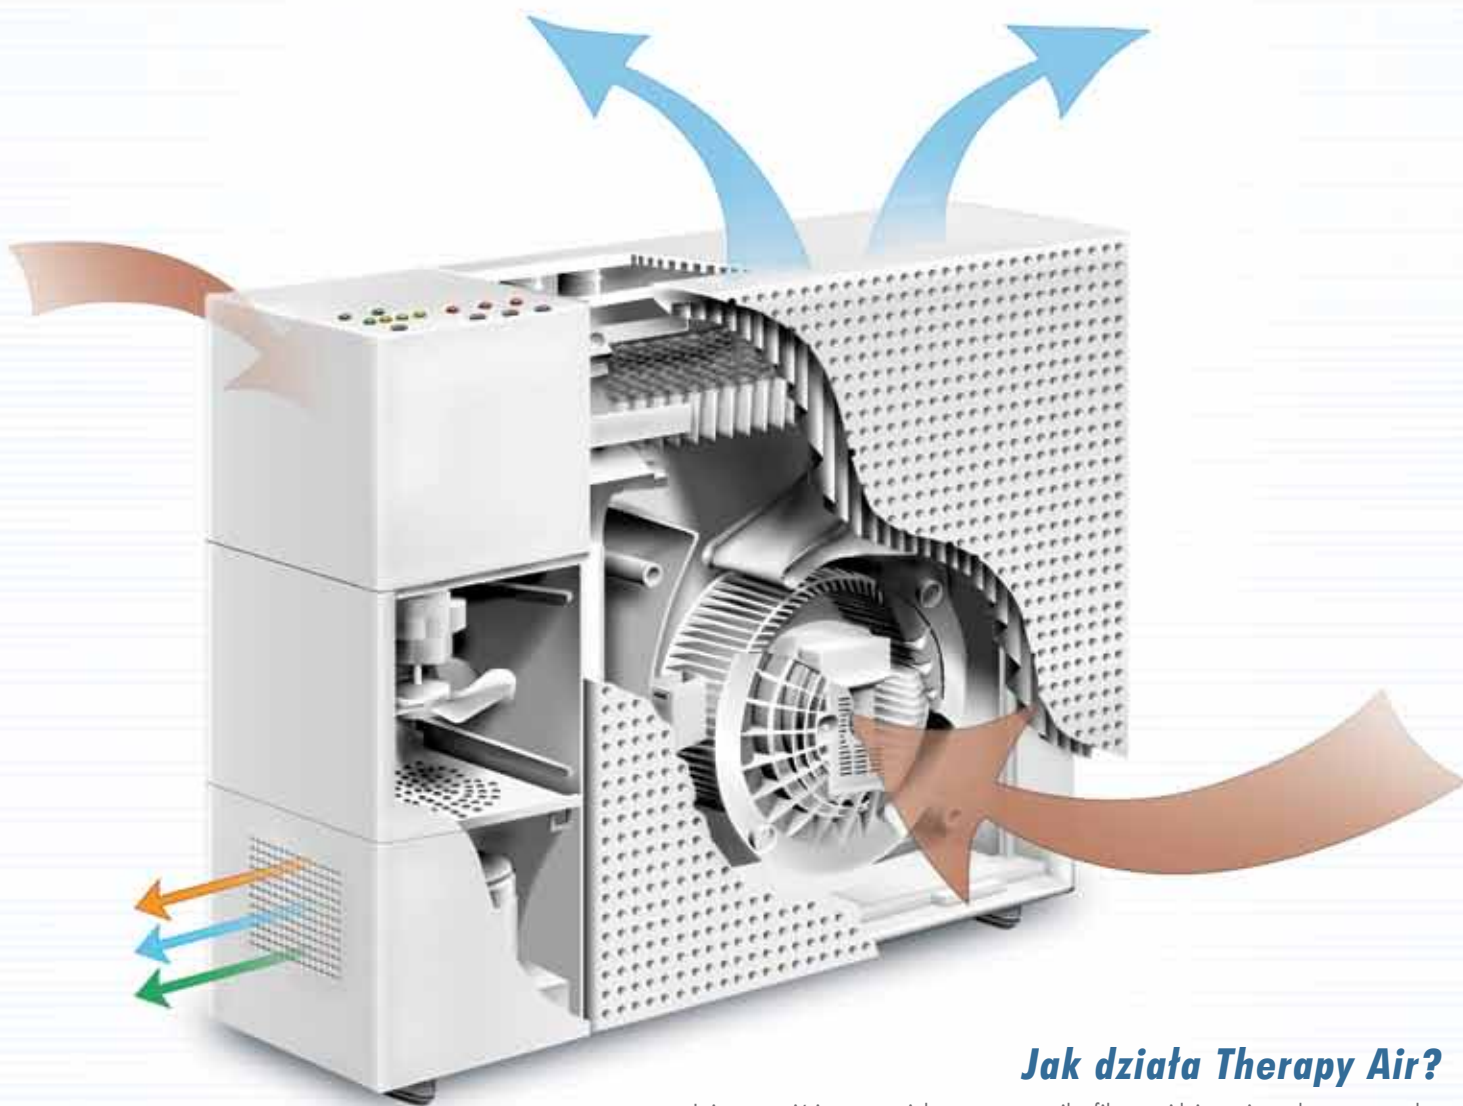

Therapy Air ma elegancką formę, niewielkie rozmiary i delikatny pastelowy kolor, dzięki czemu pasuje do każdego pomieszczenia. Pomoże każdemu, kto dba o swoje zdrowie i kondycję psychofizyczną. Czyste powietrze sprawi, że dzieci będą się uczyły chętniej i z lepszymi efektami, i poprawi każdemu samopoczucie, zarówno osobom zdrowym, jak i chorym.

Jak działa Therapy Air?

Już po przejściu przez wielowarstwowy mikrofiltr, znajdujący się pod przepuszczalną pokrywą obudowy urządzenia Therapy Air, powietrze jest tak czyste, że usatysfakcjonowałoby najbardziej wymagającego producenta filtrów.

Następnie w komorze, w której odbywa się proces uaktywniania tlenu i do której powietrze jest wdmuchiwane za pomocą głównego wentylatora, atomy aktywnego tlenu powodują utlenienie organicznych i większości nieorganicznych substancji lotnych. Następuje proces ich neutralizowania oraz eliminowania mikroorganizmów, ponieważ aktywny tlen szkodzi ich strukturom komórkowym.

Katalizator, w skład którego wchodzi filtr węglowy, minimalizuje ilość substancji szkodliwych pozostałych jeszcze w przepływającym powietrzu. Filtr węglowy usuwa setki gazów i nieprzyjemnych zapachów znajdujących się wszędzie wokół nas oraz wcześniej utlenione substancje składowe powietrza.

Po przejściu przez katalizator oczyszczone powietrze wydostaje się z Therapy Air przez kratkę wylotu, która kieruje je w górę pomieszczenia, ułatwiając cyrkulację i skracając czas cyklu oczyszczania.

Powietrze znów zostaje zassane, tym razem przez dziurkowaną powierzchnię na tylnej ścianie obudowy, za pomocą mniejszego wentylatora do komory, w której znajduje się pojemnik z żelem Swissological. Zanim zostanie wydmuchane ponownie do pomieszczenia, powietrze zostaje wzbogacone naturalnymi makrocząsteczkami zawartymi w żelu. Mają one zdolność adsorpcji substancji zanieczyszczających powietrze, a dzięki powtarzającym się cyklom oczyszczania wszystkie zanieczyszczenia, razem z cząsteczkami zawartymi w żelu zostaną usunięte z pomieszczenia przez Therapy Air.

Żel Swissological nie tylko pomaga przy oczyszczaniu, ale również uzdatnia powietrze. W jego skład wchodzi również przedostające się do powietrza cząsteczki aromatyczno-zapachowe, które wywołują w nas uczucie przyjemności i ogólnie wpływają na nas pozytywnie. Oznacza to, że przez cały czas działania Therapy Air będziemy poddani również aromaterapii.

Lecznicze działanie zapachów znano już w starożytności.

W zestawie z Therapy Air mogą Państwo otrzymać trzy różne rodzaje żelów aromatycz-



no-zapachowych, które działają następująco:

SWISSOLOGICAL RELAX

- uspokaja i odpręża

SWISSOLOGICAL ENERGY

- stymuluje energię i podnosi koncentrację

SWISSOLOGICAL HAPPINESS

- utrzymuje w nas dobre samopoczucie przez cały dzień.

Badania naukowe dowodzą, że zdolność do nauki i pracy, apetyt, chęć do zabawy, umiejętność pokonywania stresów, aktywność seksualna, sympatie i antypatie zależą właśnie od zapachów.

Zastosowanie urządzenia



Therapy Air może być z Państwem w każdym pomieszczeniu

Gdzie może być stosowany Therapy Air? We wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.

Therapy Air może być z Państwem w każdym pomieszczeniu: w salonie, w pokoju dzieciennym, kuchni, a dzięki cichej pracy nawet w sypialni.



Dzieci są najbardziej narażone na działanie substancji toksycznych zawartych w powietrzu.

Zastanówmy się, czy Therapy Air nie jest potrzebny w pokoju dzieciennym? Prosto ze szpitala noworodki trafiają zwykle do świeżo pomalowanych pokoi dzieciennych z nową wykładziną, nowym łóżeczkiem, materacem, kocykami i zabawkami, czyli do pomieszczenia o wysokim stężeniu substancji toksycznych, które się mogą ulatniać przez całe lata.

Therapy Air znajdzie zastosowanie w każdej kuchni. Czy Państwo wiedzą że wg najnowszych badań naukowców Narodowego Instytutu Raka w USA (NCA) przegrzane mięso i niektóre rodzaje olejów emitują substancje mutagenne uszkadzające strukturę DNA, które mogą wywołać raka.

W sypialni spędzamy bardzo dużo czasu. Therapy Air zapewni nam spokojne sny, a dzięki aromaterapii zyskamy nową energię na każdy nowy dzień.

Nasz system pomoże poprawić efekty pracy, dając zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy wiele satysfakcji. Może być stosowany:



w gabinetach lekarskich



w aptekach



w barach



w salonach fryzjerskich



w sklepach mięsnych



w sklepach z meblami ...

- w każdym biurze,
- w gabinetach lekarskich i dentystycznych, w aptekach,
- w sklepach z meblami, dywanami, wykładzinami i artykułami chemicznymi,
- w sklepach mięsnych, spożywczych, z pokarmem dla zwierząt itp.,
- w hotelach,
- w salonach odnowy biologicznej,
- w siłowniach,
- w szkołach i przedszkolach,
- w barach i restauracjach,
- w pralniach chemicznych,
- na stacjach paliw,
- w każdym pomieszczeniu, gdzie odczuwamy, że powietrze jest zanieczyszczone.

Niestety pomieszczeń z czystym powietrzem już nie ma.

Ono jest mocno zanieczyszczone nawet tam gdzie nam się wydaje, że jest zupełnie czyste. Ale jest z nami System Therapy Air.



Therapy Air powinien stać się elementem każdego standardowo wyposażonego biura.



Gimnastyka czy aerobik w pomieszczeniu z Therapy Air jest dużą przyjemnością i daje lepsze efekty.

W biurach zwykle otaczają nas meble z płyt paździerzowych emitujące rakotwórczy formaldehyd. A poza tym wykładziny, kleje, lakiery itp., albo systemy wentylacyjne, które mogą spowodować pojawienie się groźnej bakterii Legionelli?

Źródłem zanieczyszczenia powietrza jest też sam człowiek. Poza dwutlenkiem węgla wydziela aż 150 różnych substancji lotnych, takich jak wodór, metan, amoniak, lotne kwasy tłuszczowe, fenole, aldehydy, indol, aceton itp. Gimnastyka czy aerobik w pomieszczeniu z Therapy Air jest dużą przyjemnością i daje lepsze efekty.

Urządzenie jest lekkie, a dzięki praktycznemu uchwytnemu może być przenoszone nawet przez dzieci. Z powodzeniem można je zabrać na weekend na działkę albo na urlop. Therapy Air jest nowoczesny i praktyczny, a jednocześnie prosty i łatwy w obsłudze. Umożliwia trzypoziomową regulację przepływu powietrza. Dzięki świecącym diodom na panelu obsługi zawsze będą Państwo poinformowani o jego trybie pracy. Nie będą Państwo musieli pamiętać o terminie wymiany żelu, mikrofiltra lub katalizatora. Przypomną o tym czerwone diody znajdujące się na panelu obsługi, które zapalając się, sygnalizują konieczność dokonania wymiany. Zarówno dostęp do części zamienialnych, jak i ich wymiana nie stwarzają użytkownikowi żadnych trudności.

Zużycie prądu przez Therapy Air jest niewielkie, wręcz symboliczne. Można je porównać do zużycia prądu przez średniej mocy żarówkę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy najpierw zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa (8. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa).

1. Sposób korzystania z instrukcji



Symbol występuje w niniejszej instrukcji w miejscach, w których - w przypadku niewłaściwego użytkowania - narażeni są Państwo na niebezpieczeństwo porażenia prądem. Aby wyeliminować tego typu zagrożenie należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji.



Symbol ten pojawia się w niniejszej instrukcji w miejscach, w których występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia Therapy Air z powodu niewłaściwego użytkowania. Także i w tym przypadku, aby nie doprowadzić do uszkodzenia, powinni Państwo przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji.



W miejscach oznaczonych tym symbolem znajdą Państwo porady, wskazówki i przydatne informacje szczegółowe.



Tym symbolem oznaczono sposób wykonywania określonych czynności. Symbol informuje, że opisane czynności należy obecnie wykonać.



Symbol informuje, co dzieje się z urządzeniem po wykonaniu danej czynności. Dzięki temu mogą Państwo stwierdzić, czy opisane czynności zostały wykonane w sposób prawidłowy.

2. Opis urządzenia Therapy Air

2.1. Zakres dostawy

Do zakresu dostawy systemu Therapy Air należą:


- Urządzenie, w którym znajdują się mikrofiltr i katalizator
- olej zapachowy Swissological o długotrwałym działaniu typu "Relax", "Happiness" lub "Energy".

Dodatkowo:

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

2.2. Urządzenie Therapy Air

Rys. 2-1 Therapy Air -
przednia ścianka
urządzenia

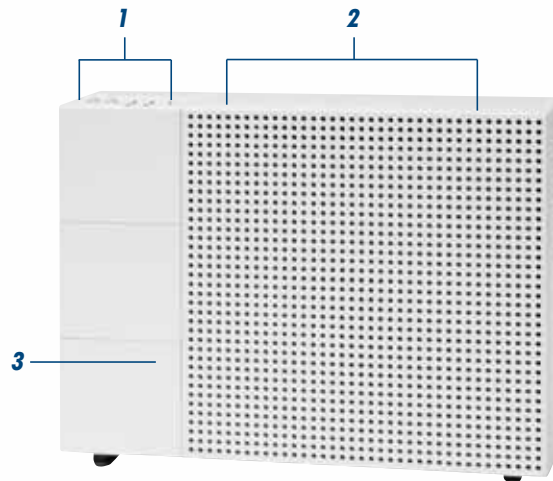

1. Panel obsługi
2. Uchwyty do otwierania pokrywy
3. Pokrywa schowka na pojemnik z żelom zapachowym

Therapy Air posiada cztery systemy wylotu/wlotu powietrza:

- Zasysanie powietrza przez powierzchnię perforowaną na przedniej ściance oraz powierzchnię perforowaną na tylnej ściance urządzenia.
- Wydmuchiwanie oczyszczonego powietrza (zassanego wcześniej z pomieszczenia) poprzez podłużne szczeliny na górnej ściance urządzenia.
- Wydmuchiwanie powietrza wzbogaconego żelom zapachowym poprzez powierzchnię perforowaną po lewej stronie obudowy.

► Otwory urządzenia nie powinny być zakryte żadnymi przedmiotami, materiałem itp., ponieważ uniemożliwia to optymalną cyrkulację i oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu.


Rys.2-2 System Therapy Air - tylna
ścianka urządzenia



1. Uchwyt - zagłębienie do przenoszenia urządzenia
2. Włącznik/wyłącznik (włącznik główny)
3. Tabliczka znamionowa (patrz spód urządzenia)
4. Przewód zasilający (wtyczka sieciowa)

2.3. Panel obsługi

Na górnej ścianie urządzenia (rys.2-1) znajduje się panel obsługi. Umieszczono tu przycisk umożliwiający przełączanie wentylatora na poszczególne prędkości oraz diody informujące o pracy wentylatora, stanie żelu zapachowego, mikrofiltra i katalizatora.

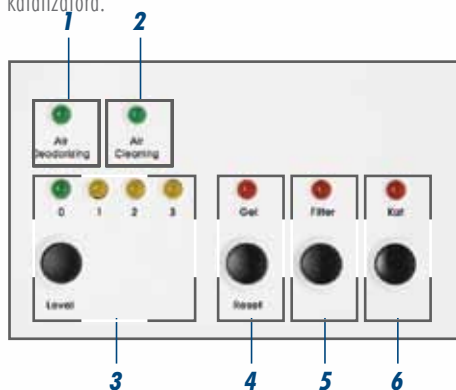


Rys. 2-3 Panel obsługi

1. **Air Deodorizing (dezodoryzacja powietrza)** - dioda informująca o pracy w trybie „air deodorizing”. Zapala się wówczas, gdy urządzenie Therapy Air zostało uruchomione przy użyciu włącznika głównego. Wentylator do żelu zapachowego jest aktywny.
2. **Air Cleaning (oczyszczanie powietrza)** - dioda informująca o oczyszczaniu powietrza „air cleaning”. Zapala się w przypadku uruchomienia wentylatora głównego, łącznie z jednostką do oczyszczania powietrza.
3. **LEVEL** - przycisk i diody związane z prędkościami wentylatora „0” (WYŁĄCZONY) i „1” do „3” (WŁĄCZONY). W ten sposób włącza się poszczególne prędkości wentylatora głównego.
4. **RESET** - dioda informująca o konieczności wymiany żelu i przycisk potwierdzenia (RESET). Migotanie tej diody oznacza, że pojemnik z żelem należy wymienić (4.3. - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym).
5. **FILTR** - dioda informująca o konieczności wymiany mikrofiltra i przycisk potwierdzenia. Migotanie tej diody oznacza, że należy wymienić mikrofiltr (4.4. - Wymiana mikrofiltra).
6. **KAT** - dioda informująca o konieczności wymiany katalizatora i przycisk potwierdzenia. Migotanie diody oznacza, że należy wymienić katalizator (4.5. - Wymiana katalizatora).

3. Główne części Therapy Air

3.1. Mikrofiltr - specjalny mikrofiltr uwalnia powietrze w pomieszczeniu od unoszących się w nim substancji.

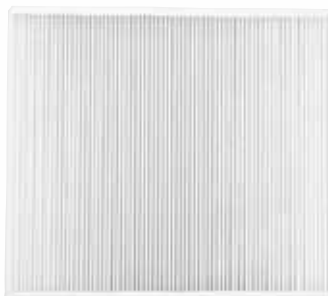

Rys. 3-1 Mikrofiltr

Urządzenie Therapy Air dostarczane jest z zamontowanym mikrofiltrem. Konieczność wymiany mikrofiltra sygnalizuje miganie diody FILTR znajdującej się na panelu obsługi.

Zużyty mikrofiltr utylizuje się poprzez wyrzucenie go do pojemnika razem z pozostałymi odpadami domowymi.

3.2. Katalizator - jednostka aktywująca tlen i katalizator, wyposażony w filtr z węglem aktywnym, uwalniają przepływające przez urządzenie powietrze od substancji toksycznych i od nieprzyjemnych substancji zapachowych

Rys.3-3 Katalizator



Urządzenie jest wyposażone w katalizator. Konieczność wymiany katalizatora sygnalizuje miganie diody KAT znajdującej się na panelu obsługi.

Zużyty katalizator utylizuje się poprzez wyrzucenie go do pojemnika razem z pozostałymi odpadami domowymi.

3.3. Żele zapachowe Swissological

Rys. 3-3 Pojemniki z żelem Swissological



Wraz z urządzeniem Therapy Air otrzymają Państwo jeden z trzech rodzajów żelu zapachowego Swissological: Relax, Energy lub Happiness.

3.4. Wentylatory - system Therapy Air wyposażony jest w dwa oddzielne wentylatory:

- Wentylator główny wytwarza strumień powietrza umożliwiając filtrację powietrza i aktywację tlenu. Przy użyciu znajdującego się na panelu obsługi przycisku "Level" mogą Państwo włączać trzy prędkości wentylatora ("1 - 3") lub wyłączyć go ("0") (2.3.- Panel obsługi).
- Wentylator do żelu służy do usuwania nieprzyjemnych zapachów i aromatyzuje powietrze. Uruchamiany jest natychmiast po doprowadzeniu do urządzenia zasilania i włączeniu włącznika znajdującego się na tylnej ścianie. Informuje o tym dioda "air deodorizing".



4. Obsługa

Uwaga! Przed otwarciem obudowy w celu wymiany filtra lub pojemnika z żelem zapachowym Swissological zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie wolno dokonywać żadnych zmian we wnętrzu urządzenia, które nie byłyby zgodne z niniejszą instrukcją. Wszystkie elementy wyposażenia i akcesoria skonstruowane są w taki sposób, żeby ich montaż i demontaż odbywał się bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

4.1. Pierwsze uruchomienie

Urządzenie Therapy Air dostarczane jest w opakowaniu kartonowym. Mikrofiltr i katalizator są już zamontowane fabrycznie - urządzenie jest gotowe do pracy. Należy tylko przygotować pojemnik z żelem zapachowym i umieścić go w przeznaczonym do tego miejscu urządzenia (4.3. - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym).

Teraz urządzenie można włączyć do sieci i uruchomić.

4.2. Uruchamianie Therapy Air

Przy wyborze miejsca dla urządzenia Therapy Air należy zwrócić uwagę, czy powierzchnia, na której ma być ustawione, jest idealnie równa. Układ zabezpieczający przed uszkodzeniem podzespołów mechanicznych uniemożliwia użytkowanie urządzenia w stanie przechylonym.

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, które odnoszą się do sposobu ustawiania urządzenia (8 - Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Włączenie Therapy Air



Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy dane dotyczące napięcia sieciowego podane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem w Państwa sieci. W przypadku braku takiej zgodności urządzenia nie wolno uruchamiać, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

- ▶ Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
- ▶ Włączyć włącznik/wyłącznik znajdujący się z tyłu urządzenia na pozycję "1" (WYŁĄCZONY).
- ✓ Diody znajdujące się na panelu obsługi zapalą się po kolei na ok. cztery sekundy.

W ten sposób urządzenie samo dokonuje sprawdzenia gotowości.



Rys.4-1 Poziom prędkości "0"

- ✓ Jednocześnie zapala się dioda poziomu "0" prędkości wentylatora (rys.4-1). Wentylator główny jest włączony.



Rys.4-2 Air Deodorizing - wentylator do żelu uruchomiony

- ✓ Teraz zostaje włączony wentylator do żelu. Informuje o tym świecenie diody "air deodorizing".



Wentylator do żelu zaczyna działać natychmiast po przyłączeniu Therapy Air do sieci i włączeniu włącznika/wyłącznika. Wentylator działa nawet wtedy, gdy wciśnięty jest poziom "0" (WYŁĄCZONY) wentylatora głównego. Następnie można wybrać odpowiednią prędkość wentylatora urządzenia głównego.

Ustawienie odpowiedniej prędkości wentylatora głównego

System Therapy Air posiada trzy poziomy prędkości wentylatora, które można dowolnie włączać i przełączać.

- ▶ Wcisnąć przycisk "Level" w celu ustawienia wentylatora na wysokość obrotów "1".



Rys. 4-3
Prędkość "1".

- ✓ Wentylator główny przez krótką chwilę będzie pracował na najwyższych obrotach, a następnie przełączy się na prędkość "1". Zaświeci się dioda "1" (rys.4-3).



Przy każdej zmianie prędkości obrotowej wentylatora na wyższą wentylator główny przełączany jest na ok. trzy sekundy na najwyższe obroty, aby w ten sposób pokonać ewentualne tarcie w łożyskach. Po tym "skoku" na najwyższych obrotach wentylator przełączy się na nastawioną przez Państwa prędkość.

- ▮ W celu przełączenia wentylatora na poziom obrotów wyższy od aktualnego należy ponownie wcisnąć przycisk "Level".
 - ✓ Teraz zaświeci się odpowiednia dioda, wentylator ponownie włączy się na najwyższe obroty, a następnie przełączy się i będzie pracował na nastawionej przez Państwa prędkości.

Wyłączenie wentylatora głównego

- ▮ Wcisnąć przycisk "Level" tyle razy, aż wentylator przejdzie na prędkość "3". Wtedy nacisnąć przycisk "Level" jeszcze raz, żeby przełączyć na prędkość obrotową "0" (WYŚCZONY).
- ✓ Gdy wentylator główny kończy pracę - zapala się dioda poziomu prędkości obrotowej "0".

4.3. Wymiana pojemnika z żelem zapachowym Swissological

Należy wybrać pojemnik z żelem zapachowym według własnego uznania (3.3 Trzy rodzaje żelów zapachowych)

Przygotowanie żelu zapachowego Swissological



Rys. 4-4 Przygotowanie pojemnika z żelem zapachowym

- ▮ Odkręcić wieczko pojemnika z żelem zapachowym.
 - ▮ Na otwarty pojemnik założyć pokrywę z regulowanymi otworami.
- ▮ Otworzyć pokrywę, przesuwając bolec.
 - ▮ Teraz można umieścić pojemnik z żelem zapachowym w przeznaczonym do tego miejscu urządzenia Therapy Air.

Wymiana pojemnika z żelem Swissological

- ▮ Ustawić znajdujący się na tylnej ścianie urządzenia przełącznik na pozycję "0" (WYŚCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- ▮ Nacisnąć lekko prawy górny róg pokrywy schowka na pojemnik z żelem (rys. 4-5).

Pokrywa pojemnika otwiera się.



Rys. 4-5 Otwieranie schowka na pojemnik z żelem

- ▮ Wyjąć (w razie potrzeby) znajdujący się w urządzeniu pojemnik z żelem.
 - ▮ Włożyć nowy pojemnik z żelem zapachowym do schowka na pojemnik i dosunąć do oporu (rys. 4-6).

Rys. 4-6 Wkładanie pojemnika z żelem do schowka



Należy zachować wieczko pojemnika, aby w przypadku zaprzestania użytkowania Therapy Air ponownie można było zamknąć pojemnik.

- ▣ Zamknąć schowek na pojemnik z żelem poprzez ponowne naciśnięcie na prawy górny róg pokrywy do momentu zatrzaśnięcia.

Teraz można ponownie uruchomić urządzenie (4.2 Uruchamianie urządzenia Therapy Air)



W przypadku wymiany żelów zapachowych, np. w celu wypróbowania nowego zapachu, należy hermetycznie zamknąć nie do końca opróżniony pojemnik z żelem zapachowym, używając właściwego wieczka. Taki żel można przechować i ponownie użyć nawet po pół roku (od momentu pierwszego użycia).

Jeżeli w urządzeniu Therapy Air miga dioda informująca o konieczności wymiany żelu (2.3. - Panel obsługi), oznacza to, że należy wymienić pojemnik z żelem. Po dokonaniu wymiany należy potwierdzić dokonanie wymiany. W przypadku stosowania różnych żelów zapachowych poleca się sprawdzanie zapasu żelu zapachowego w pojemniku co 1 - 2 tygodnie.

Potwierdzenie wymiany pojemnika z żelem zapachowym Swissological

Rys.4-7 Dioda informująca o konieczności wymiany żelu



Miga dioda informująca o konieczności wymiany żelu, co oznacza, że należy wymienić pojemnik z żelem zapachowym (rys, 4-7).

Po dokonaniu wymiany należy "poinformować" urządzenie Therapy Air, że wymiana została dokonana.

- ▣ Włączyć urządzenie do sieci i ustawić znajdujący się na jego tylnej ścianie przełącznik na pozycję "1" (WŁĄCZONY).
- ▣ Naciśnąć przycisk "Reset" umieszczony pod diodą informującą o konieczności wymiany żelu i przytrzymać w tej pozycji przez ok. 5 sekund, do momentu wygaśnięcia diody (rys. 4-8).

Rys.4-8 Potwierdzenie wymiany żelu



- ✓ Dioda informująca o konieczności wymiany żelu będzie w ciągu ww. 5 sekund migać z dużą częstotliwością - urządzenie Therapy Air odczyta Państwa potwierdzenie dokonania wymiany.

Teraz mogą Państwo znowu używać Therapy Air.

4.4. Wymiana mikrofiltra

System Therapy Air sygnalizuje - poprzez migotanie diody informującej o konieczności wymiany mikrofiltra (rys.4-9). Wymiana następuje najwcześniej po upływie sześciu miesięcy.



Rys. 4-9 Dioda informująca o konieczności wymiany filtra

- ▣▣▣▣ Ustawić umieszczony na tylnej ścianie urządzenia przełącznik na pozycję "0" (WY_ŃCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- ▣▣▣▣ Stanąć przodem do urządzenia i otworzyć przednią pokrywę, pociągając ją w zaznaczonych miejscach kciukami w kierunku do siebie i odchylić ku dołowi (rys. 4-10).



Rys 4-10 Otwieranie pokrywy obudowy



Należy zapamiętać sposób umieszczenia mikrofiltra w pokrywie obudowy. Ułatwi to Państwu założenie nowego filtra.



Rys. 4-11. Wyjmowanie zużytego mikrofiltra.

- ▣▣▣▣ Następnie należy wyjąć stary mikrofiltr z pokrywy obudowy (rys. 4-11).
- ▣▣▣▣ Usunąć ostrożnie opakowanie ochronne z nowego mikrofiltra, uważając, żeby go nie uszkodzić.

Najlepiej wyjmować mikrofiltr na zewnątrz pomieszczenia, np. w pobliżu śmietnika.

- ▣▣▣▣ Włożyć nowy mikrofiltr w prowadnicę pokrywy obudowy. Podłużne żeberka filtra muszą - po ponownym zamknięciu pokrywy - znaleźć się w pozycji pionowej. Zewnętrzne zakładki filtra należy po lewej i prawej stronie zaczepić o prowadnicę, aby podczas przenoszenia urządzenia mikrofiltr nie uległ przesunięciu (rys. 4-12).


Rys. 4-12 Zewnętrzne zakładki filtra zaczepić o prowadnicę.



Teraz można ponownie zamknąć pokrywę obudowy.

- ▣▶ Następnie należy wsunąć dolną część pokrywy obudowy w oba przewidziane do tego miejsca Therapy Air (rys.4-13) i zamknąć pokrywę, podnosząc ją do góry i dociskając do zatrzaśnięcia.

Rys. 4-13 Zamykanie pokrywy obudowy

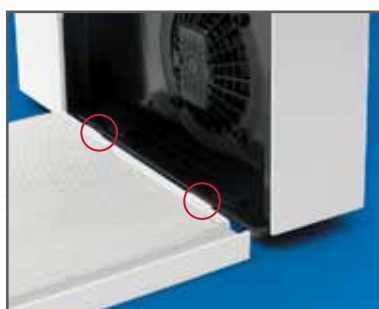

Należy "poinformować" urządzenie Therapy Air o dokonanej wymianie mikrofiltra.

Potwierdzenie dokonania wymiany mikrofiltra

- ▣▶ Włączyć urządzenie do sieci i ustawić przełącznik znajdujący się na tylnej ścianie na pozycję "1" (WŁĄCZONY).
- ▣▶ Nacisnąć przycisk "Reset" umieszczony pod diodą informującą o konieczności wymiany mikrofiltra i przytrzymać w tej pozycji przez ok. 5 sekund, do czasu wygaśnięcia diody (rys.4-14).

Rys. 4-14 Potwierdzenie wymiany mikrofiltra



- ✓ Dioda informująca o konieczności wymiany mikrofiltra będzie przez ww. 5 sekund migać z dużą częstotliwością i zgaśnie, jeśli urządzenie Therapy Air "odczyta" Państwa potwierdzenie dokonania wymiany.

- ▣▶ Zużyty mikrofiltr należy utylizować poprzez wyrzucenie go do pojemnika z innymi odpadami domowymi.

Urządzenie Therapy Air jest gotowe do ponownego użytkowania.

4.5. Wymiana katalizatora

Miganie diody informującej o konieczności wymiany katalizatora (rys. 4-15) sygnalizuje, że należy wymienić katalizator. Wymiana następuje najwcześniej po roku.

Rys. 4-15 Dioda informująca o konieczności wymiany katalizatora



- ▣▣▣▣ Ustawić umieszczony na tylnej ścianie urządzenia przełącznik na pozycję "0" (WYŚNIZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ▣▣▣▣ Otworzyć przednią pokrywę, chwytając ją za wyłobione powierzchnie (w kształcie rowków) i pociągając kciukami do siebie i następnie odchylając ku dołowi (rys. 4-16).

Rys. 4-16 Otwieranie pokrywy obudowy urządzenia



- ▣▣▣▣ Odchylić obie klamry mocujące obudowę katalizatora do przodu, ku sobie (4-17).

Rys. 4-17 Otwieranie klamer mocujących katalizatora



- ▣▣▣▣ Wyciągnąć starą obudowę katalizatora z Therapy Air (rys.4-18).

Rys. 4-18 Wymywanie obudowy katalizatora



- ▣▣▣▣ Usunąć ostrożnie opakowanie ochronne z nowego katalizatora, uważając, żeby go nie uszkodzić.
- ▣▣▣▣ Wsunąć katalizator do wnętrza Therapy Air i zamknąć obie klamry mocujące, dociskając je do zatrzaśnięcia. Należy zwrócić uwagę, aby boczne prowadnice katalizatora znajdowały się we właściwym położeniu, jak to pokazano na rys. 4-19.


Rys. 4-19 Wsuwanie obudowy katalizatora



Pokrywą obudowy Therapy Air można teraz ponownie zamknąć.

- ▣▣▣▣ Wsunąć dolną część pokrywy obudowy w oba wgłębienia Therapy Air (rys. 4-20) i zamknąć ją, podnosząc do góry i dociskając do zatrzaśnięcia.

Rys. 4-20 Zamykanie pokrywy obudowy urządzenia

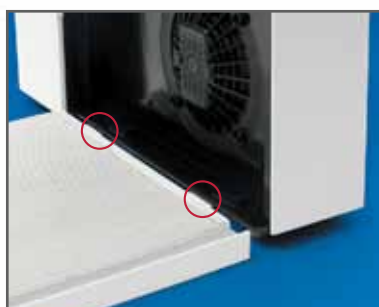

Należy "poinformować" Therapy Air o dokonanej wymianie katalizatora.

Potwierdzenie wymiany katalizatora

- ▣▣▣▣ Włączyć ponownie Therapy Air do sieci i ustawić znajdujący się na tylnej ściance urządzenia przełącznik na pozycję "1" (WŁĄCZONY).
- ▣▣▣▣ Nacisnąć przycisk "Reset" umieszczony pod diodą informującą o konieczności wymiany katalizatora i przytrzymać w tej pozycji przez ok. 5 sekund, do wygaśnięcia diody (rys.4-21).

Rys. 4-21 Potwierdzenie wymiany katalizatora



- ✓ Dioda informująca o konieczności wymiany katalizatora będzie w ciągu ww. 5 sekund migać z dużą częstotliwością i zgaśnie w momencie, gdy Therapy Air "odczyta" Państwa potwierdzenie dokonania wymiany.

- ▣▣▣▣ Zużyty katalizator wraz z obudową należy wyrzucić wraz z pozostałymi odpadami domowymi.

Urządzenie Therapy Air jest ponownie gotowe do użytkowania.

4.6. Wyłączenie Therapy Air

- ▣▣▣▣ Ustawić przełącznik umieszczony na tylnej ściance Therapy Air na pozycję "0" (WY_ŃCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Jeżeli Therapy Air jest podłączony do sieci, a przełącznik ustawiony w pozycji "1" (W_ŃCZONY), wentylator do żelu także działa. Dlatego, gdy urządzenie Therapy Air nie jest używane, przełącznik należy ustawić w pozycji "0" (WY_ŃCZONY).

Jeżeli nie mają Państwo zamiaru używać Therapy Air przez dłuższy czas, należy zdjąć pokrywę z regulowanymi otworami i zakręcić wieczko pojemnika na żel Swissological, aby znajdujący się w nim żel zapachowy nie ulatniał się.

- ▣▣▣▣ Wyjąć pojemnik z żelem zapachowym w wyżej opisany sposób (4-3 - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym).
- ▣▣▣▣ Zamknąć wieczko pojemnika z żelem zapachowym.



Należy pamiętać, że raz użyte pojemniki z żelem zapachowym (nawet szczelnie zamknięte) można przechowywać nie dłużej niż ok. pół roku.

4.7. Transport Therapy Air

- ▣▣▣▣ Ustawić przełącznik umieszczony na tylnej ściance Therapy Air na pozycję "0" (WY_ŃCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

°el Swissological znajdujący się w pojemniku może w określonych temperaturach, np. w lecie, ulec upłynięciu. Przed transportem należy go dobrze zakręcić, aby płynny żel się wylał do wnętrza urządzenia Therapy Air.

- ▣▣▣▣ Wyjąć pojemnik z żelem zapachowym, zakręcić wieczko i ponownie zamknąć schowek na pojemnik z żelem (4.3).
- ▣▣▣▣ Przy podnoszeniu Therapy Air należy uchwycić za zagłębienia znajdujące się na tylnej ściance urządzenia (rys.4-22).



Rys. 4-22 Podnoszenie urządzenia

Teraz można przetransportować urządzenie Therapy Air w dowolne miejsce.

- ▣▣▣▣ Następnie należy ponownie odkręcić wieczko pojemnika na żel i założyć na niego pokrywę z regulowanymi otworami. Urządzenie Therapy Air jest ponownie gotowe do użytkowania.

5. Czyszczenie



Uwaga! Therapy Air jest urządzeniem z podzespołami elektrycznymi. Dlatego nigdy nie należy umieszczać go w wodzie ani spryskiwać wodą. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

Ewentualne zabrudzenia obudowy urządzenia najlepiej oczyścić wilgotną ściereczką, w razie potrzeby nanosząc na nią niewielką ilość środka do mycia naczyń.

6. Usuwanie zakłóceń w pracy urządzenia

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy urządzenia w tej części instrukcji znajdą Państwo pomoc w usunięciu problemów.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wentylator nie działa, diody nie świecą.	Therapy Air nie jest włączony.	Sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy wtyczka jest włożona do gniazdka, czy włącznik/wyłącznik nie jest nastawiony na pozycję "0" (WY_NCZONY) i czy w gniazdku jest napięcie (podłączyć do innego źródła energii elektrycznej).
	Therapy Air nie jest umieszczony na równej powierzchni.	Układ zabezpieczający przed przechyłem wyłącza Therapy Air, jeśli nie jest on umieszczony pionowo. Ustawić go na równej powierzchni.
	Katalizator został założony niewłaściwie.	Sprawdzić, czy obudowa katalizatora została prawidłowo wsunięta i czy klamry mocujące są zamknięte (4.5 - Wymiana katalizatora).
	Pokrywa urządzenia jest nieprawidłowo zamknięta.	Dociśnąć pokrywę Therapy Air (przednią pokrywę używaną do otwierania Therapy Air np. w przypadku wymiany filtra) do momentu zatrzasknięcia.
W pomieszczeniu nie odczuwa się świeżego zapachu.	Pojemnik z żelem zapachowym jest pusty.	Włożyć nowy pojemnik z żelem zapachowym (4.3 - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym)
	Pojemnik z żelem zapachowym ma jeszcze zamknięte wieczko.	Odkręcić i zdjąć wieczko z pojemnika na żel zapachowy (4.3 - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym).
	Pokrywa z regulowanymi otworami nie została otwarta.	Otworzyć pokrywę z regulowanymi otworami (4.3 - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym)
Miga jedna lub kilka czerwonych diod.	Czas na wymianę pojemnika z żelem zapachowym, mikrofiltra lub katalizatora.	Należy wymienić pojemnik z żelem zapachowym, mikrofiltr lub katalizator. (4.3, 4.4, 4.5)

We wszystkich innych przypadkach należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu producenta.

7. Dane techniczne i gwarancja

7.1. Dane techniczne

Wymiary	Szer. 51,5 x wys. 40,0 x głęb. 14,0 cm
Ciężar	6,5 kg
Zasilanie	220 V AC - 240 V AC, 50 Hz
Moc	Maks. 100 W
Temperatura robocza (od do)	0-40 stopni
Obroty wentylatora głównego	Maks. 1400 obr./min.
Obroty wentylatora do żelu	Maks. 1500 obr./min
Maksymalna wielkość pomieszczenia	120 m ³
Stopień szczelności	IP 20
Znak jakości	VDE

7.2. Częstotliwość wymiany filtra i żelu Swissological

Podane niżej częstotliwości ustalane są dla Therapy Air w zależności od faktycznie przepracowanych godzin i w związku z tym dla urządzenia rzadko używanego poniższe przedziały czasowe mogą być dłuższe. Zużyte mikrofiltry, katalizatory i pojemniki z żelem zapachowym wyrzuca się wraz z innymi odpadami domowymi (brak żółtego punktu).

Pojemnik z żelem zapachowym	Mniej więcej raz na kwartał w przypadku, gdy wentylator pracuje głównie na prędkościach 0,1 lub 2
	Mniej więcej co 2 miesiące przy częstej pracy wentylatora na prędkości 3
Mikrofiltr	Najwcześniej co pół roku
Katalizator	Najwcześniej raz w roku

Pojemniki z żelem zapachowym, który był już używany, mogą być przechowywane i ponownie używane w okresie do pół roku, o ile były hermetycznie zamknięte za pomocą przeznaczonego do tego celu wieczka.

7.3. Postanowienia gwarancji

Udzielamy gwarancji na działanie urządzenia Therapy Air. Gwarancja wynosi 24 miesiące. Termin gwarancji liczy się od daty zakupu przez Państwa Therapy Air potwierdzonej na karcie gwarancyjnej podpisem i pieczętką. Szczegółowe postanowienia znajdują się w Karcie Gwarancyjnej urządzenia.

8. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

8.1. Sposób korzystania z urządzenia Therapy Air

- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie, używać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Therapy Air podczas pracy musi być umieszczone na równej powierzchni.
- Podczas pracy urządzenie zasysa powietrze z otoczenia, dlatego nie należy stawiać go w pobliżu otwartego ognia. Musi być ustawione w odległości co najmniej 50 cm od grzejników i innych źródeł ciepła.
- Do wnętrza Therapy Air nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów. Prosimy w szczególności zwracać uwagę na to, aby wirnik wentylatora nigdy nie był zablokowany.
- Szczeliny wlotu i wylotu powietrza nie mogą być zakryte. Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych przedmiotów.
- Przed włączeniem prosimy sprawdzać, czy Therapy Air, a w szczególności przewód zasilający, nie jest uszkodzony. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Kiedy urządzenie nie pracuje, a także przed przystąpieniem do wymiany filtrów lub pojemników z żelem zapachowym, wtyczka powinna być wyjęta z gniazdka.
- Napięcie i częstotliwość w Państwa sieci energetycznej muszą być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- W przypadku, gdy wirnik wentylatora nieoczekiwanie przestanie działać z powodu awarii, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W pobliżu Therapy Air nie należy używać żadnych preparatów w aerozolu (sprayów).
- Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez upoważniony serwis firmowy.
- Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, aby móc korzystać z niej także w przyszłości. Jeśli chcą Państwo przekazać Therapy Air innym osobom, prosimy dołączyć do urządzenia niniejszą instrukcję obsługi.

8.2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

System TherapyAir jest urządzeniem do oczyszczania i uzdatniania powietrza:

- Eliminuje z powietrza w pomieszczeniu szkodliwe substancje.
- Redukuje nieprzyjemne zapachy.
- Poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki specjalnym substancjom aromatyczno-zapachowym.

Zastrzega się, że należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne dopuszczone przez producenta (mikrofiltr, katalizator i pojemnik z żelem zapachowym Swissological).

Inne zastosowanie Therapy Air niż opisane w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem.

Producent nie uzna reklamacji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem. Dotyczy to w szczególności stosowania filtrów lub katalizatorów innych producentów oraz używania innych substancji zapachowych np. olejków eterycznych, dymów aromatycznych albo żeli innych marek.



www.therapyair.com

